



GWP® Recommendation


Empresa Demo
Contacto Raul Palacios
Departamento / cargo Mantenimiento
Código postal / localidad 17 Quito
País Ecuador

Requerimientos del proceso		Valor	Unidad
Carga de pesada máxima		15	kg
Peso neto más pequeño		140	g
Tolerancia de pesada		0,2	%
Factor de seguridad requerido		2	
Emplazamiento		Producción/exterior	
Plataforma especificada			
Plataforma especificada		ICS465k-count-15LA/f (75000d/60000d)	
Capacidad		15	kg
Legibilidad		0,2	g
Ajuste interno automático		Sí	





Evaluación			
Peso mínimo típico ¹⁾ el 0,2% de tolerancia de pesaje		82	g
Peso neto más pequeño		140	g
Factor de seguridad calculado ²⁾		1,71	
Factor de seguridad requerido		2	



El dispositivo especificado cumple con los requisitos del proceso. No cumple con los requisitos de los factores de seguridad.

Esta evaluación se basa en las especificaciones típicas publicadas. La precisión real y el peso mínimo de este dispositivo se deben determinar en su lugar con un GWP® Verification.

METTLER TOLEDO

Servicios recomendados
Instalación y calificación
IPac Standard Qualification

En el lugar se requiere la configuración del dispositivo

Calificación de revisión y verificación
GWP Verification*
Paquetes de servicios de asistencia
Extended Care
Pesas
Pesa 1

 (La sensibilidad y la
excentricidad)


 5 kg **Clase** M1 o superiores

Pesa 2

(Repetibilidad)

 0,5 kg **Clase** M1 o superiores

* GWP® Verification proporciona toda la información necesaria para verificar el rendimiento de por vida, como: métodos de prueba y calibración, frecuencias de prueba, prueba de las tolerancias y los procedimientos normalizados de trabajo

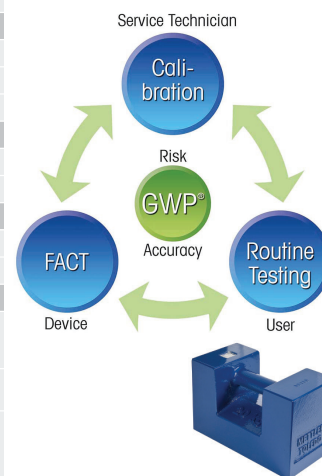
Observaciones:

- 1) El valor de peso mínimo típico se publica con un factor de seguridad de 1 (sin seguridad). El peso mínimo que se puede obtener depende del entorno, la configuración del dispositivo, el recipiente de tara y otros factores. Por lo tanto, el peso mínimo real de este dispositivo puede ser superior o inferior a los valores típicos publicados; en este sentido, METTLER TOLEDO se exime de toda responsabilidad al respecto. La determinación del peso mínimo real y del factor de seguridad aparece documentada en GWP® Verification.
- 2) Basado en el peso mínimo típico

Nota:

Las recomendaciones que se dan son sólo para fines informativos y no son vinculantes en modo alguno. La recomendación para el dispositivo de pesaje se basa en las especificaciones típicas publicadas por METTLER TOLEDO, que pueden diferir del rendimiento real del dispositivo en su ubicación. Otros factores que influyen, como el tipo de instalación, las condiciones ambientales, cointainers de tara, la experiencia de los operadores, variaciones estadísticas, etc., no se han tenido en cuenta. La responsabilidad final es con el usuario del equipo. Esta recomendación no extiende nuestra garantía de ninguna manera.

GWP Recommendation No.: Rec_DIMABRU_ICS465k-count-15LA/f (75000d/60000d)_2018-10-22_15:44:56

Versión de software: 5.4.1.0

Tabla de versiones: S5.23

CRM presupuesto sin:

Fecha de creación: 22/10/2018

Creado por: Mario Izurieta

Correo electrónico: ventasuio1@espinosapaez.com

www.mt.com/GWP

For more information


Quality certificates

 Development, production,
and testing under ISO 9001.

 Environmental management
system according to ISO 14001.

Conformité Européene

This mark assures you that our
products comply with the latest
guidelines.

Espinosa Paez S.A. - Espinosa Paez S.A.

Av. Madrid E12-31 e Isabela Católica
Quito

Ecuador

Teléfono

(593 2) 2502774

Fax

(593 2) 2502774